LAURENTIUS 29/10/2026

Marco Kropman
COBRA Medical




Medilime®

Visie



Wij proberen al meer dan 25 jaar mee te denken en te kijken door de bril van de gebruiker. Zo proberen we snel aan te sluiten bij de behoeftes en wensen van de gebruikers.
Onder gebruikers verstaan we de patiënten maar ook de verpleegkundigen en artsen. Belangrijkste daarbij is om goed te luisteren.
Op deze manier proberen wij het leven van de gebruiker aangenamer te maken.


Neus-maagsonde





Medilime®

PEG

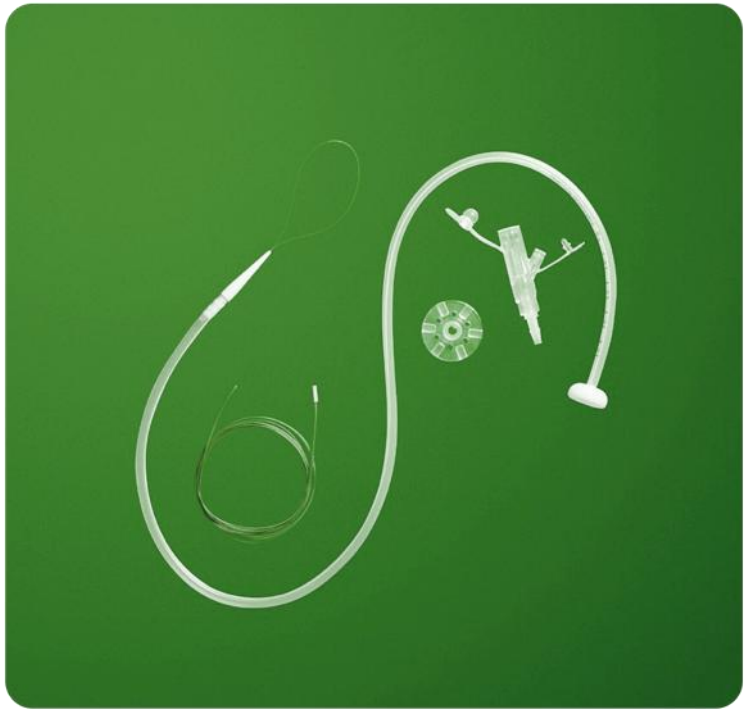



Medilime®

G-tubes


16FR. 7-10ml / cc
18FR. 10-15ml / cc
20FR. 10-15ml / cc
22FR. 10-15ml / cc
24FR. 10-15ml / cc







Medilime®

MEDILIME TUMMY BUTTON



Medilime®








Medilime®

Medilime meetkatheter

0325-00 per 2 stuks

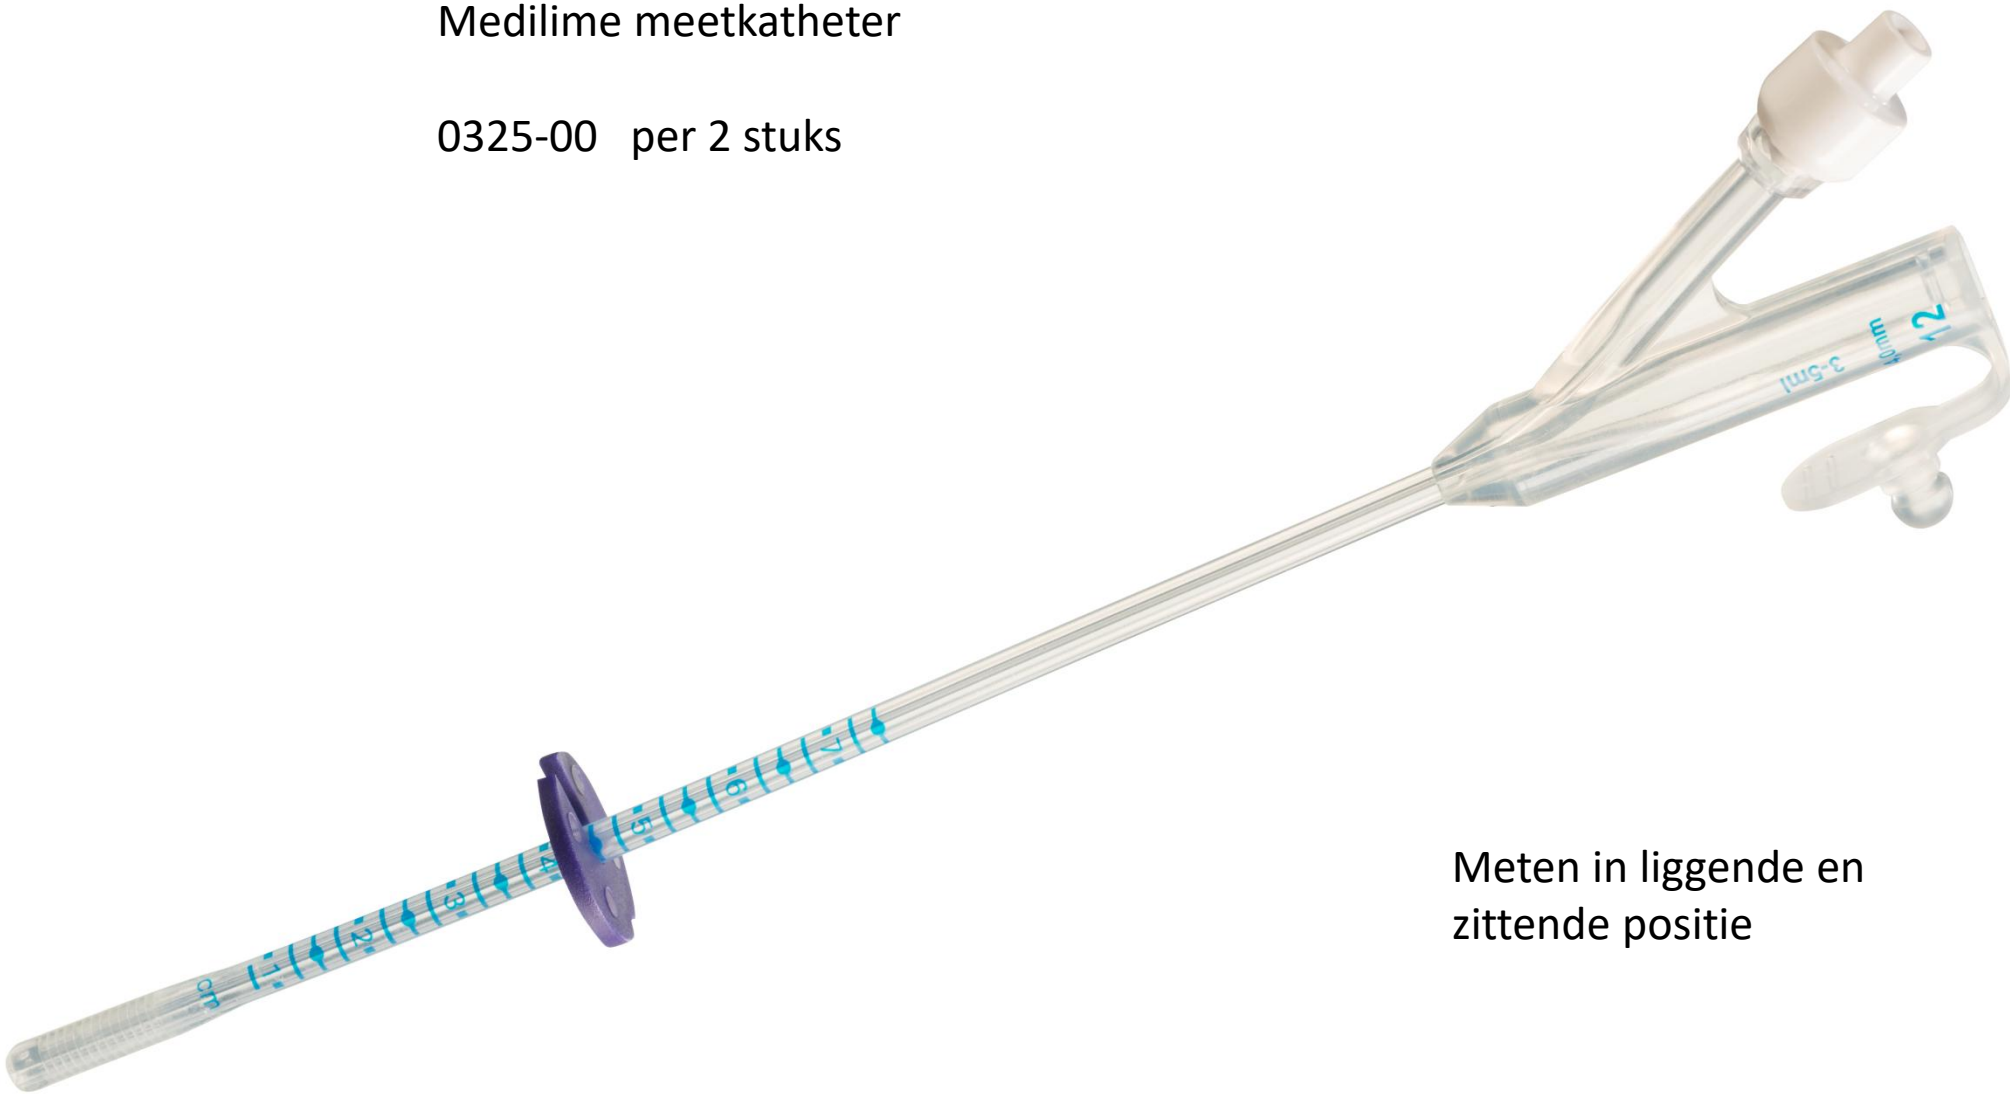

Meten in liggende en zittende positie

Medilime®

Medilime verlengslangen



Medilime®

0328



0329



0324





0323

Medilime®





Medilime®



High flow

Medilime®

ENFit

- Standaard aansluiting in oa Belgie en Nederland
- Alle producten Medilime ENFit compatable zonder koppelstukjes
- Schoonmaakborstels voor ENFit





Problemen en oplossingen
















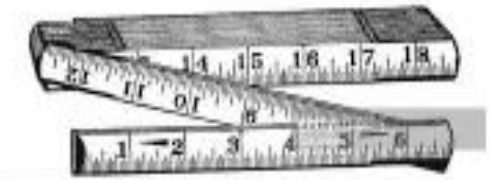


Product of Medilime




Lekkage langs de button


- Probleem is de lengte, andere diameter is geen oplossing
- Extern plaatje g- tube of PEG strakker zetten
- Soms erg complex doordat er meerdere oorzaken tegelijkertijd kunnen zijn.


Apple vs Pear

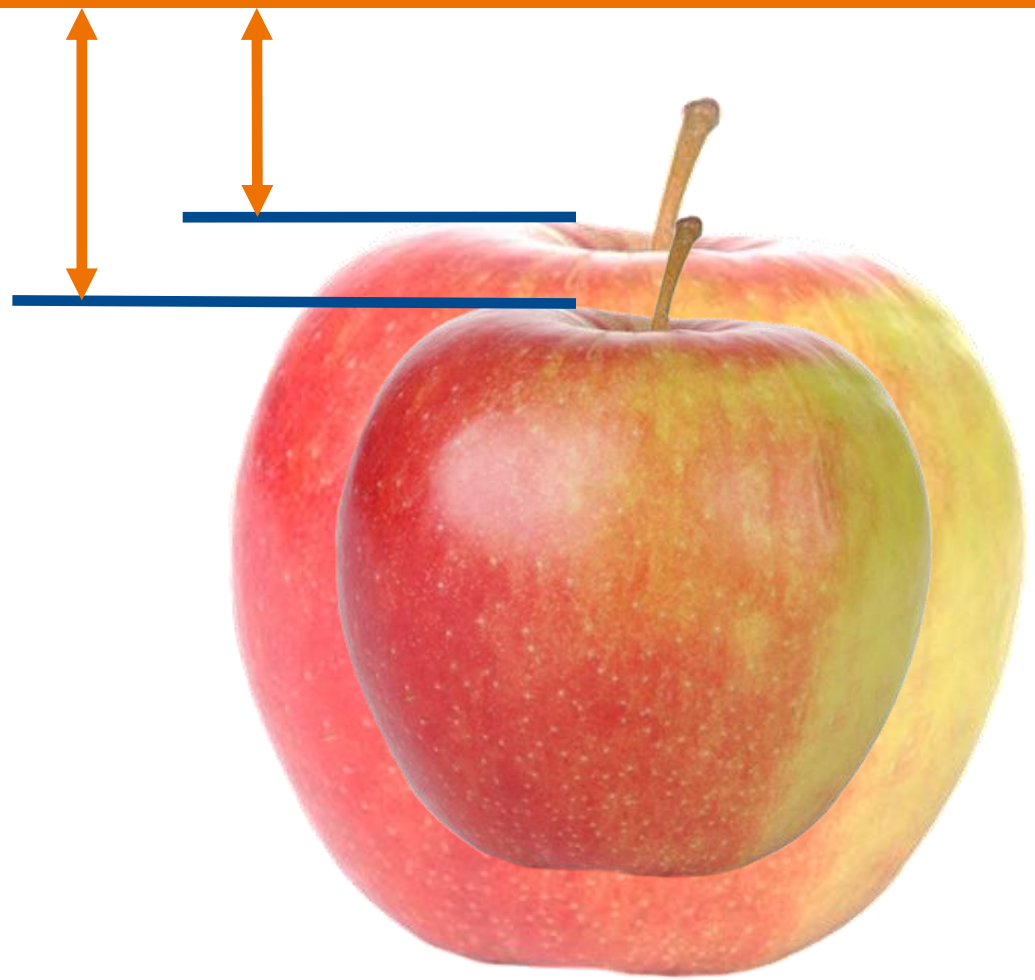

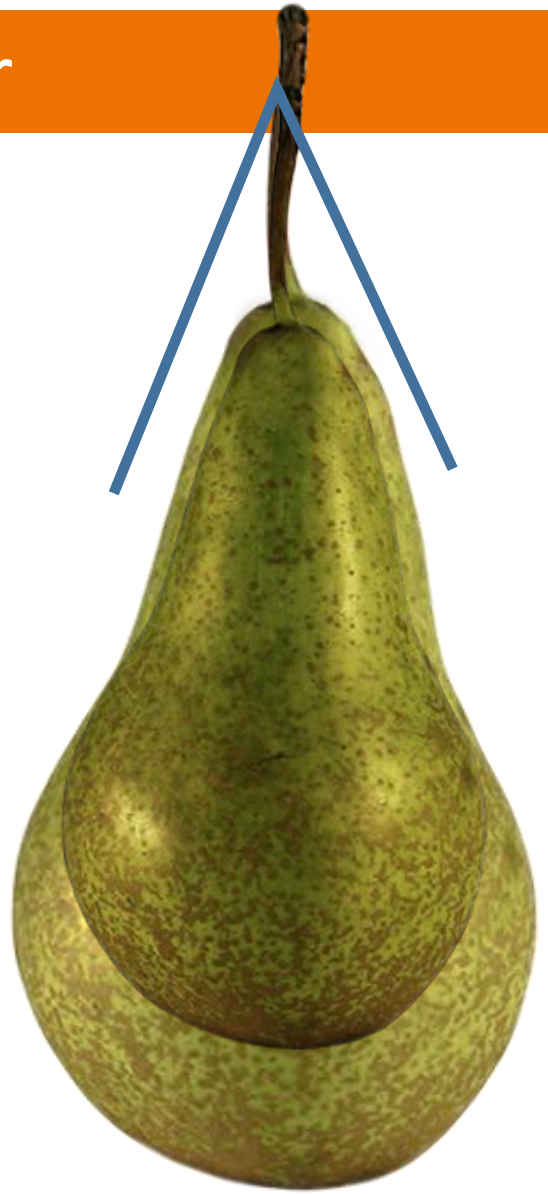

Medilime®

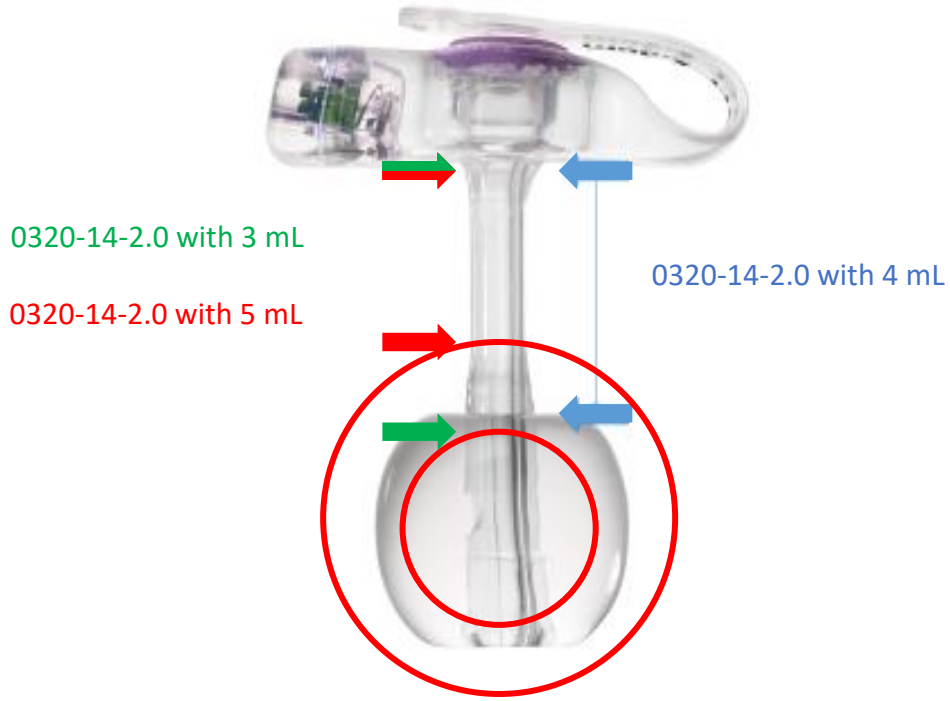

0320-14-2.0 with 3 mL
0320-14-2.0 with 5 mL
0320-14-2.0 with 4 mL

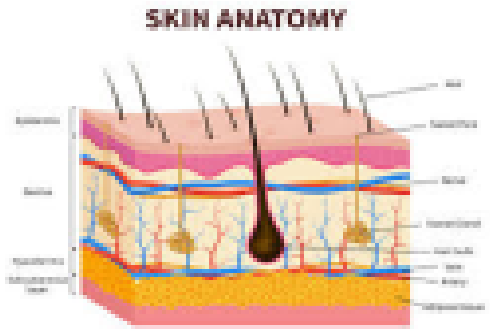

huidproblemen

- Te veel druk op de huid.
- Lekkage
- Alllergie

- Heel veel verschillende verbandmaterialen
- Maatvoering

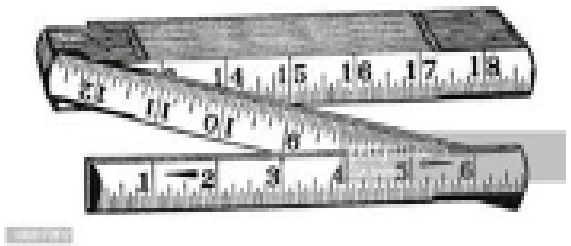

Lengte van de button

- Gewichtsverandering
- Verandering in anatomie (operatie, scoliose)

- Meetkatheter
- Appelvormige ballon



Problemen rondom medicatie

* Kan het materiaal beschadigen
* Kan verstopping veroorzaken



Blended feeding

- Welke ch gebruiken ze
- Welke extensionset gebruiken ze
- Blender

Dank!

